

オーダ発行時に関連文書を発行する方法について

作成した文書テンプレートを特定の特定のオーダを行った時に一緒に出したいといった場合、


システム管理者権限でマスタメンテナンスをすることで対応可能となります。

例) 指導料: 特定薬剤治療管理料(ハロペリドール)に「特定薬剤治療管理料」同時に発行する


マスタメンテナントタブより「マスタメンテ」を選択



表示された画面で「虫眼鏡ボタン」もしくは「マスタ選択」を選択

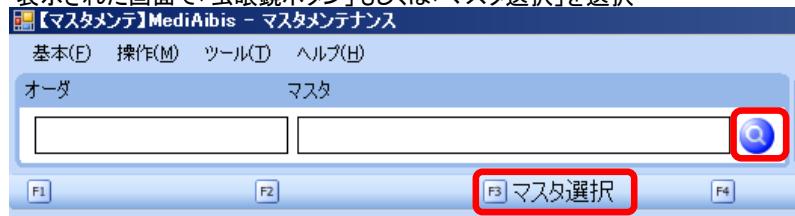

マスタ選択画面から「制御」「発行時関連文書自動印刷」を選択すると登録画面が表示されます。

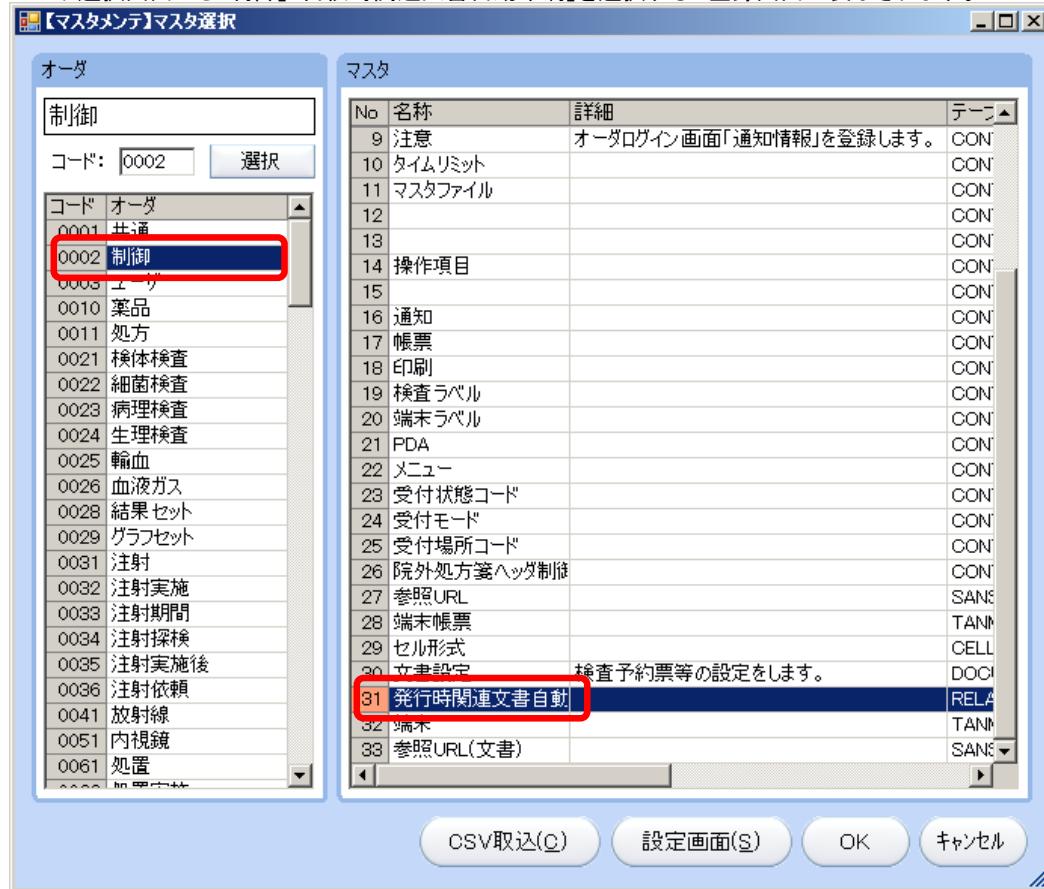

## 設定方法

### メンテナンス画面全体

【マスタメンテ】MediAibis - マスタメンテナンス

基本(E) 操作(M) ツール(T) ヘルプ(H)

オーダ	マスタ
制御	発行時関連文書自動印刷設定

F1 F2 F3 マスタ選択 F4 新規コピー F5 新規作成 F6 取り消し F7 削除 F8 登録

検索条件

オーダ種別: [ ]  
コード: [ ]  
項目コード: [ ] クリア

環境  
接続先: データベース  
モード: 編集  
利用者  
内科 / システム担当  
システム担当

オーダ種別選択  
オーダ種別: [検体検査] 決定

関連文書設定

オーダ種別	コード	名称	項目コード	項目名称
1	0021	21001 フェノバルビタール(材	147500	フェノバルビタール(材
2	0021	21002 フェニトイ(材料:静	147600	フェニトイ(材料:静
3	0021	21003 バルプロサンNa(材	147700	バルプロサンNa(材
4	0021	21004 カルバマゼピン(材	147800	カルバマゼピン(材
5	0021	21005 ゾニサミド(材料:静	148400	ゾニサミド(材料:静
6	0021	21006 クロナゼパム(材料:	236000	クロナゼパム(材料:
7	0021	21007 クロバザム(材料:静	149300	クロバザム(材料:静
8	0021	21008 エトサクシミド(材料:	148600	エトサクシミド(材料:
9	0021	21009 塩酸ピルジカイド	269100	塩酸ピルジカイド(材
10	0021	21010 コハク酸シベンゾリ	268100	コハク酸シベンゾリ(
11	0021	21011 ジンピラミド(材料:	212000	ジンピラミド(材料:
12	0021	21012 プロパフエノ(材料:	269500	プロパフエノ(材料:
13	0021	21013 フレカニド(材料:	269800	フレカニド(材料:
14	0021	21014 アプリランジン(材	148500	アプリランジン(材
15	0021	21015 メキシレチン(メキシ	990200	メキシレチン(メキシ
16	0021	21016 アミオダロン(材料:	269200	アミオダロン(材料:
17	0021	21017 テオフィリン(材料:	34000	テオフィリン(材料:
18	0021	21018 ジゴキシン(材料:静	148200	ジゴキシン(材料:静
19	0021	21019 バンコマイシン(材	990100	バンコマイシン(材
20	0021	21020 アミカシン(材料:静	229200	アミカシン(材料:静
21	0021	21021 ティコプラニン(材	179400	ティコプラニン(材
22	0021	21022 アルペカシン(材	248300	アルペカシン(材
23	0021	21023 シクロスピロソ(材	148700	シクロスピロソ(材
24	0021	21024 タクロリムス(材料:	176500	タクロリムス(材料:
25	0021	21025 炭酸リチウム(材	148000	炭酸リチウム(材
26	0021	21026 メトトレキサート(材	229800	メトトレキサート(材
27	0021	21027 ホリコナゾール(材	272500	ホリコナゾール(材


詳細情報

コード: 21001 使用開始日: 1900/01/01  
名称: フェノバルビタール(材料:静脈血) 使用期限日: 3000/12/31

表示順: 0


未定発行フラグ: 未定でも発行 文書名称: 2570\_フェノバルビタール血中濃度  
当日発行フラグ: 発行時に、当日以降のものを発行 外来時セット番号: 1466  
入外区別フラグ: 入外の区別なし 外来時文書名称: 2570\_フェノバルビタール血中濃度  
デフォルトチェック: チェック 入院時セット番号: 1466  
プレビュー・印刷有無: プレビュー表示 入院時文書名称: 2570\_フェノバルビタール血中濃度  
修正時デフォルトチェック: 表示なし

「新規作成」ボタンを押して、作成モードにします。



オーダ種別を選択します。

「検体検査」「細菌検査」などオーダ種に対して紐付け処理を行うかを選択します。  
選択可能オーダ種は下記に表示されているものが対象となります。

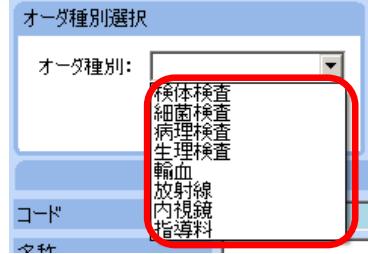


オーダ種を決めたら決定ボタンを押します。



決定ボタンを押すと、コードが自動的に採番されますので、コードを入力する必要はありません。



項目コードボタンを押すと、紐付けるための項目の一覧が表示されます。  
紐付けたい項目を選択してください。

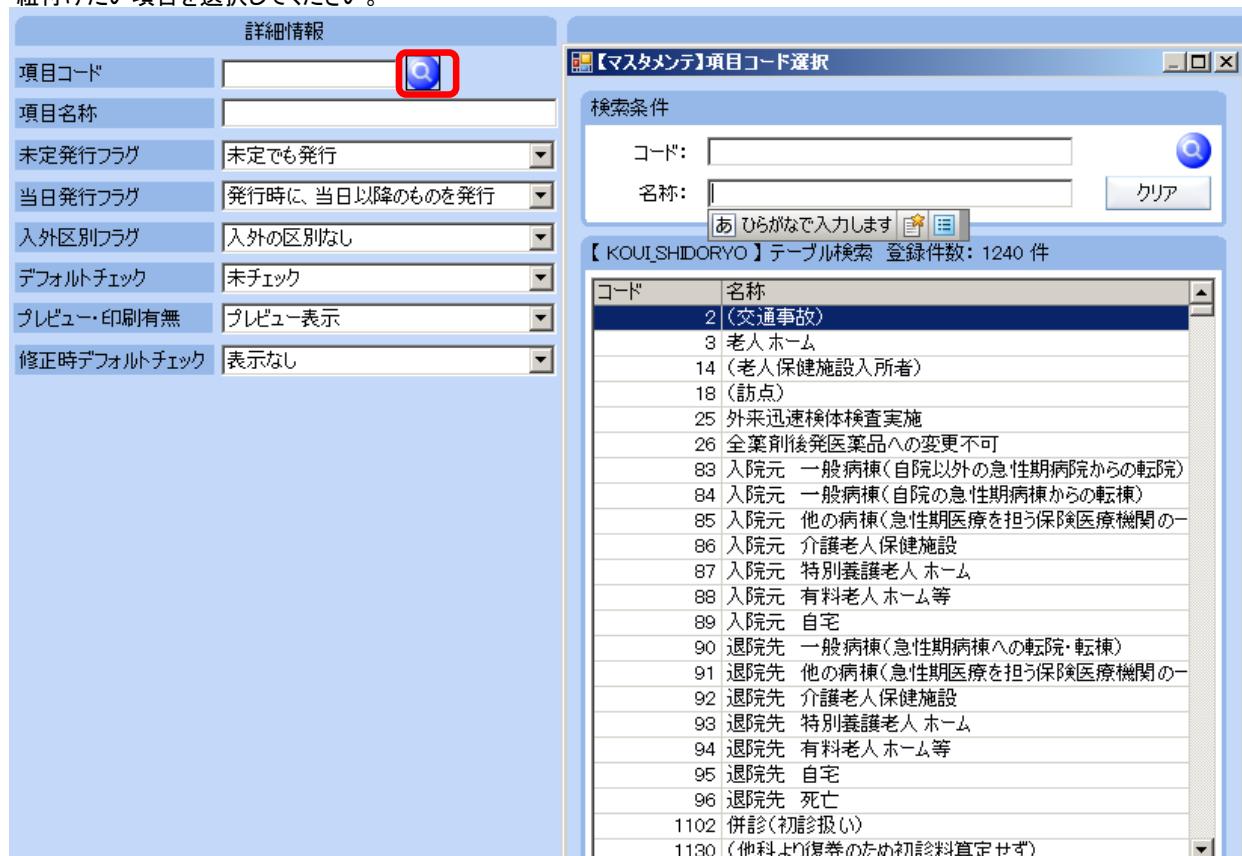

未定発行フラグ…実施日が未定の場合でも発行させるかどうかの設定になります。「未定でも発行」のままにしてください。

当日発行フラグ…実施日が当日以降の場合印刷するか、翌日以降の場合印刷するかの設定になります。「発行時に、当日以降のものを発行」のままにしてください。

入外区別フラグ…入院か外来かを判断する設定になります。「入外の区別なし」のままにしてください。

デフォルトチェック…オーダを発行する際に、印刷にチェックを入れるかどうかの初期値になります。

「未チェック」の場合は、チェックが入っていないためオーダ発行しても印刷が行われません。

「チェック」の場合は、チェックが入っているためオーダ発行する印刷が行われます。

プレビュー・印刷有無…印刷にチェックを入れている状態でオーダ発行をした際に、どのように動くかの設定になります。

「プレビュー表示」の場合は、印刷前にプレビューが表示され、その際に印刷するかどうかの確認を行えます。

「プレビューなしで印刷」の場合は、直ちに印刷されます。

「プレビュー・印刷なし」の場合は、チェックを入れても、プレビュー表示および、印刷処理が行われません。

修正時デフォルトチェック…オーダを修正した際に、印刷のチェックボックスをどうするか設定します。

「表示しない」の場合はチェックボックスが表示されないため、印刷処理を行えません。

「チェック」の場合はチェックが入っているためオーダ発行する印刷が行われます。

「未チェック」の場合は、チェックが入っていないためオーダ発行しても印刷が行われません。

紐付けたいテンプレートの種類を選択する際は「セットオーダ種別」から選択します。


セットオーダ種別	その他記録
セット番号	文書作成
文書名称	その他記録
外来時セット番号	SOAP 初診時カルテ 入院時カルテ 退院時カルテ

セットオーダ種別を選択した後にセット番号脇の虫眼鏡ボタンを押すと、テンプレート選択画面が表示されます。

紐付けたい文書を選択してください。

※3カ所全て同じ文書を選択してください。

使用期限日	3000/12/31
セットオーダ種別	その他記録
セット番号	12535
文書名称	訪問看護依頼表
外来時セット番号	12535
外来時文書名称	訪問看護依頼表
入院時セット番号	12535
入院時文書名称	訪問看護依頼表

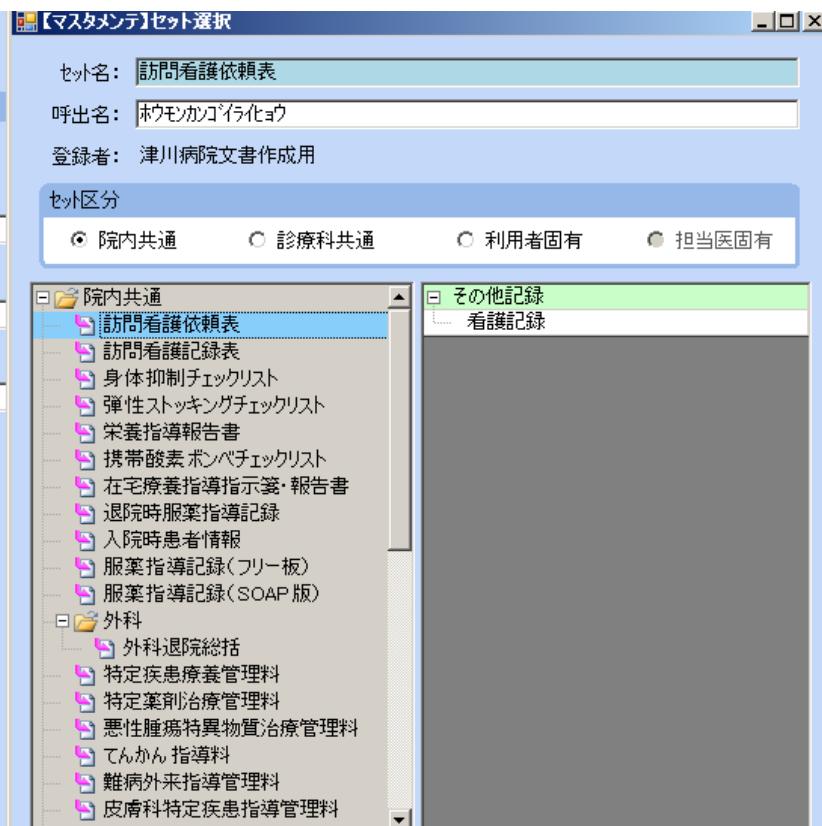

全てが終わりましたら、登録ボタンで登録できます。

登録